




Copia No controlada

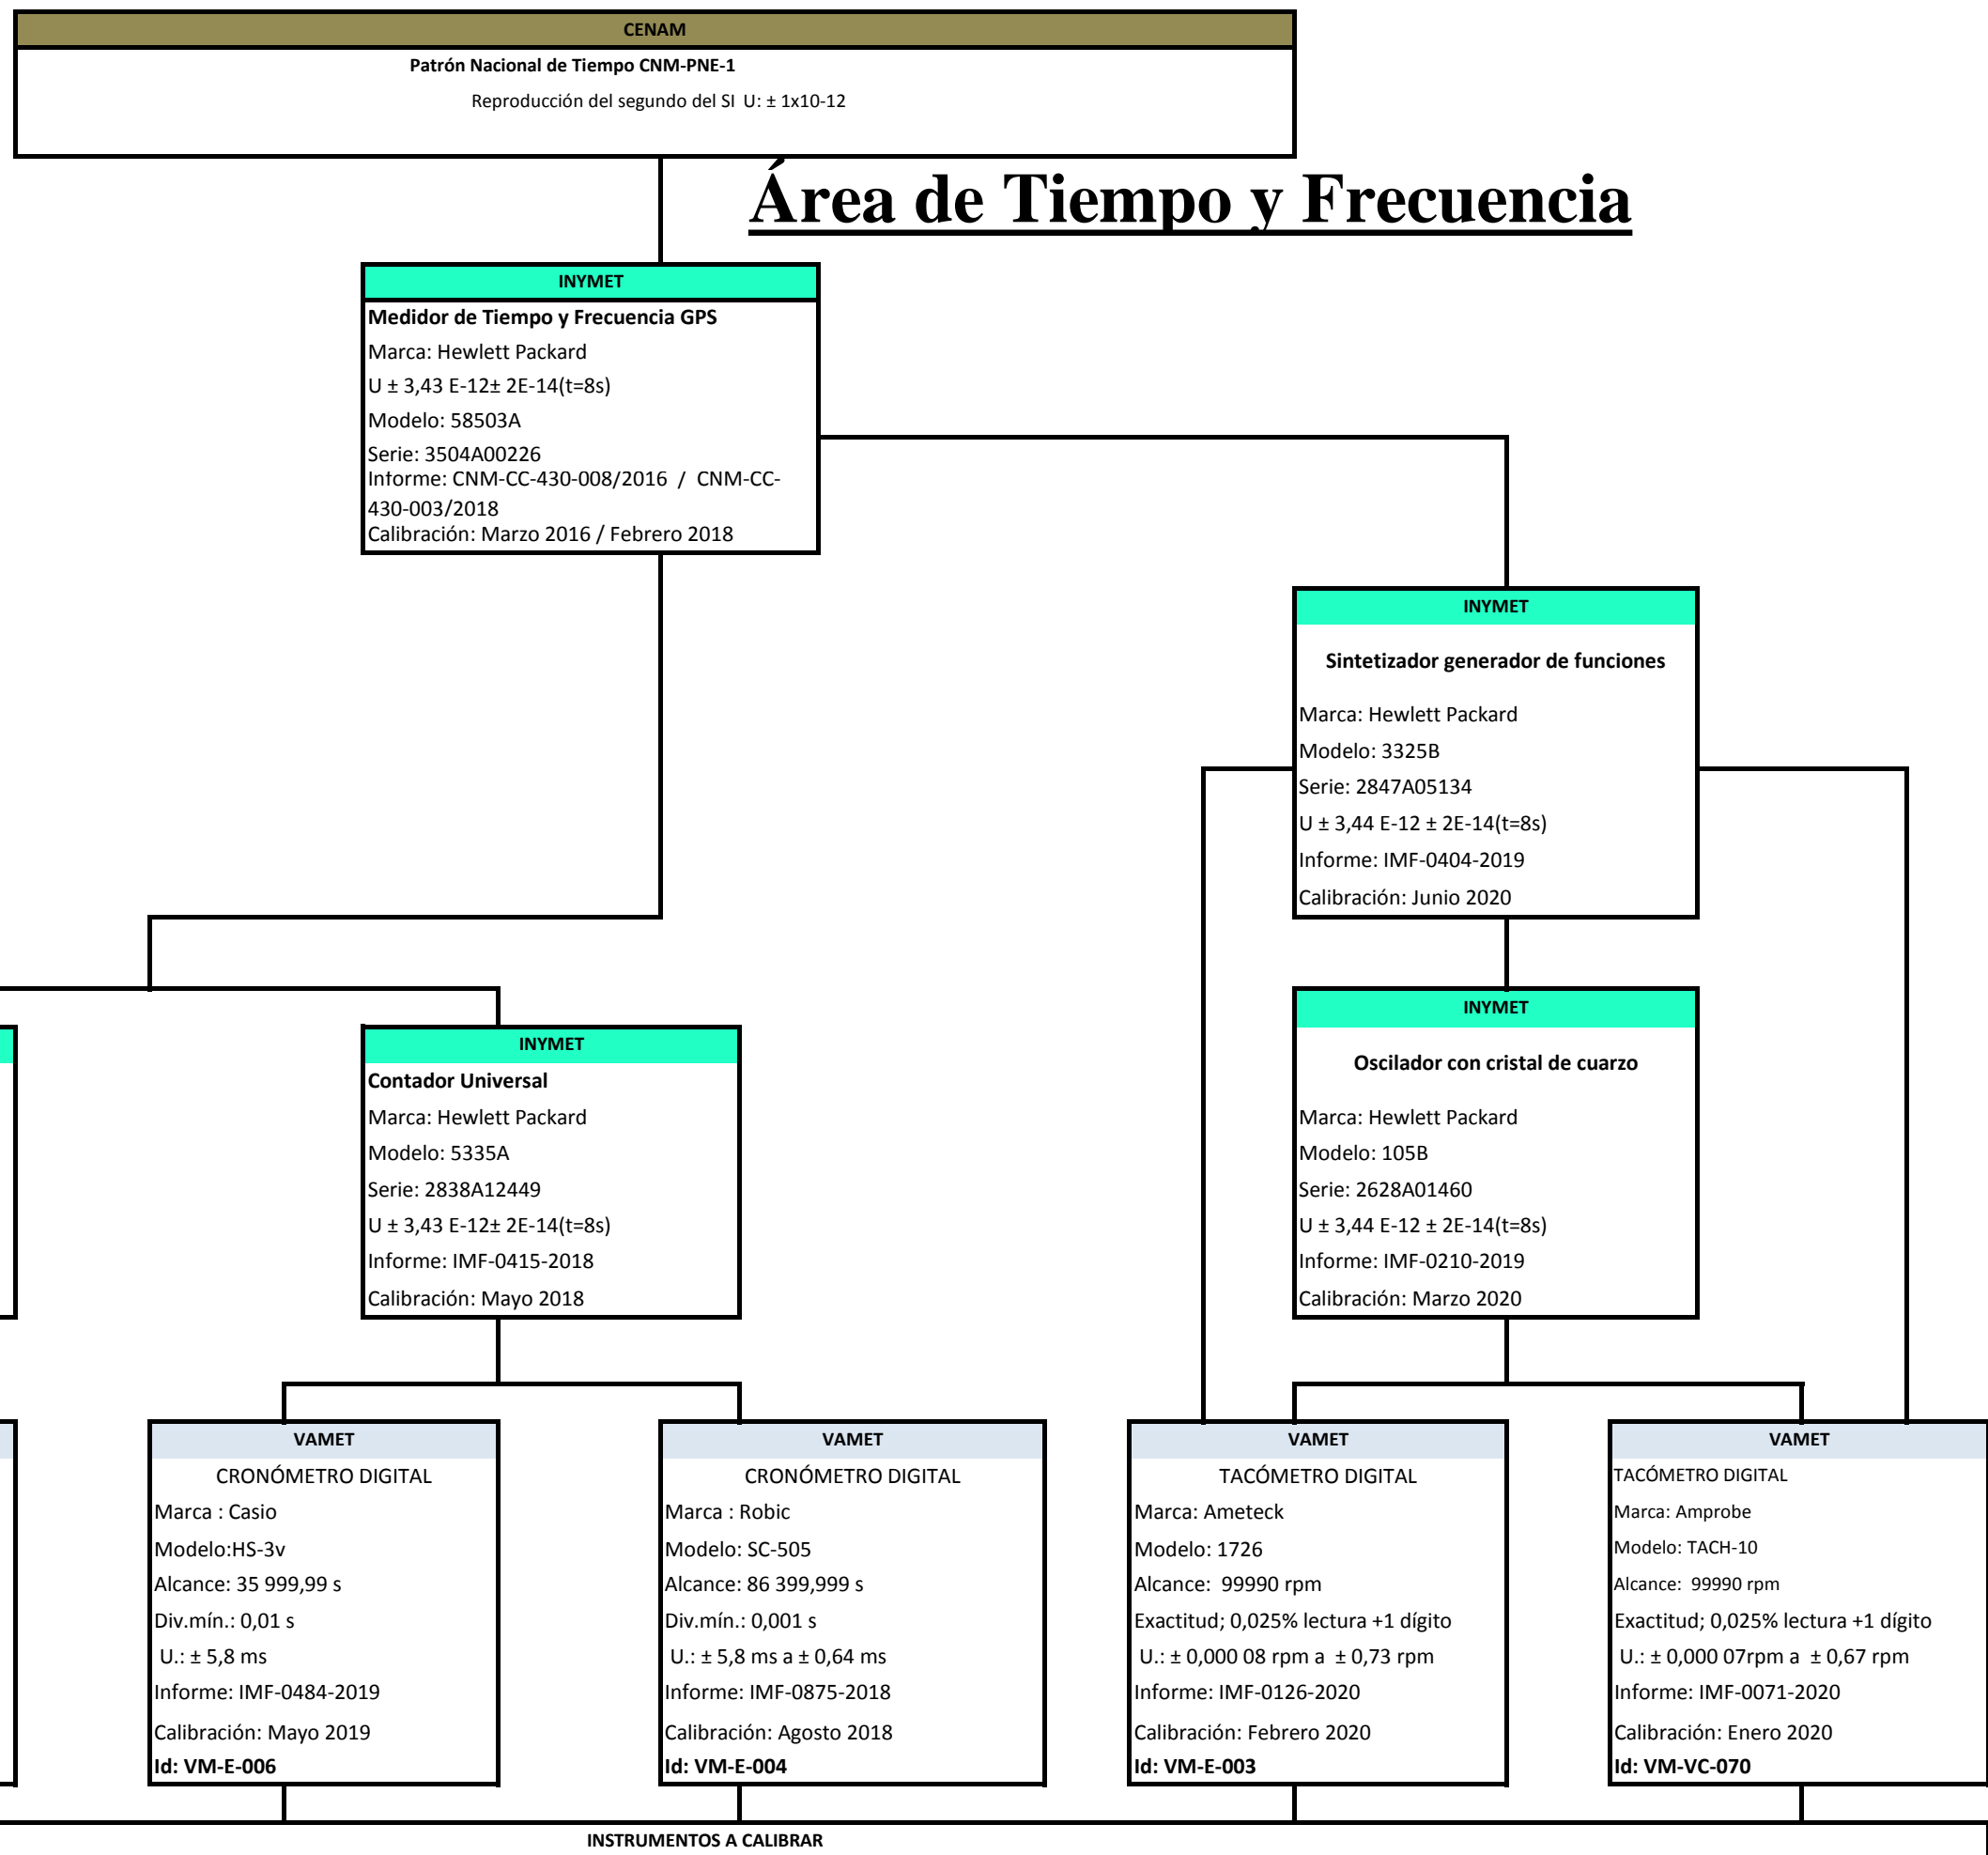

Nota 1: Incertidumbre expandida (U) reportada con un factor de cobertura k=2
Nota 2: El periodo de calibración es de 2 años.